

Utprovningsprotokoll Stålyft – Armarna Utanför

Namn:

Personnummer:


Datum:

Modell:


Storlek:

Öglor:


Förskrivare:

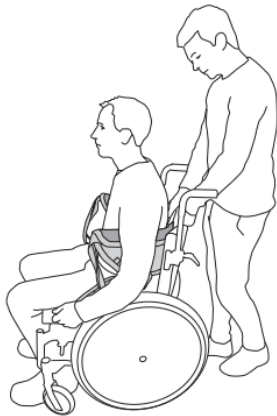

Placera västen bakom patientens rygg med produktetiketten vänd utåt. Västens nederkant ska vara i nivå med patientens midja.

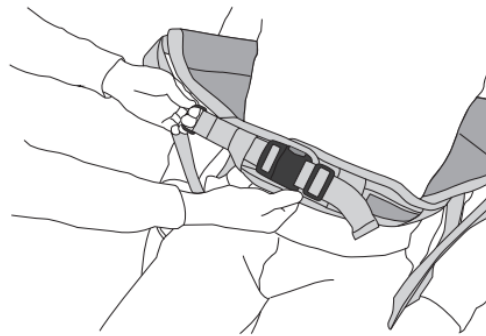


Justera midjebältet efter omkretsen runt patientens överkropp. Spänn fast midjebältets spänne.

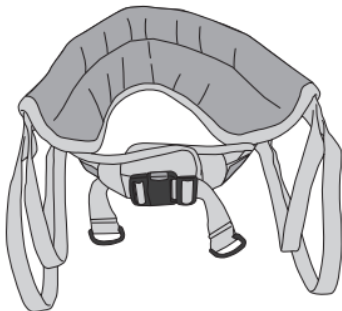


Midjebältet på uppresningsvästen är avsett att hålla västen på plats runt patienten initialt vid uppresningen.

När patienten står upp tenderar överkroppen att bli smalare. Detta kan leda till att midjebältet lossnar och hänger på patienten. Detta är naturligt och påverkar inte uppresningen.

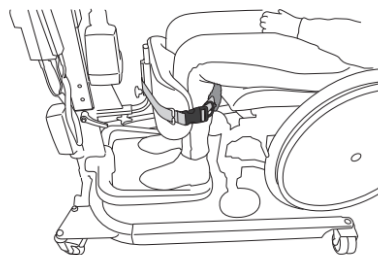


Kör fram **Sabina** lyft för sittande till stående läge och anpassa bredden på underredet så att patientens fötter kan placeras centrerat på fotplattan. Patientens underben bör vara parallella med underbensstödet. Justera höjden och djupet på stödet efter behov för att ge bekvämt stöd under knäskålen. Om tillämpligt: Fäst och dra åt vadbandet runt underbenen.

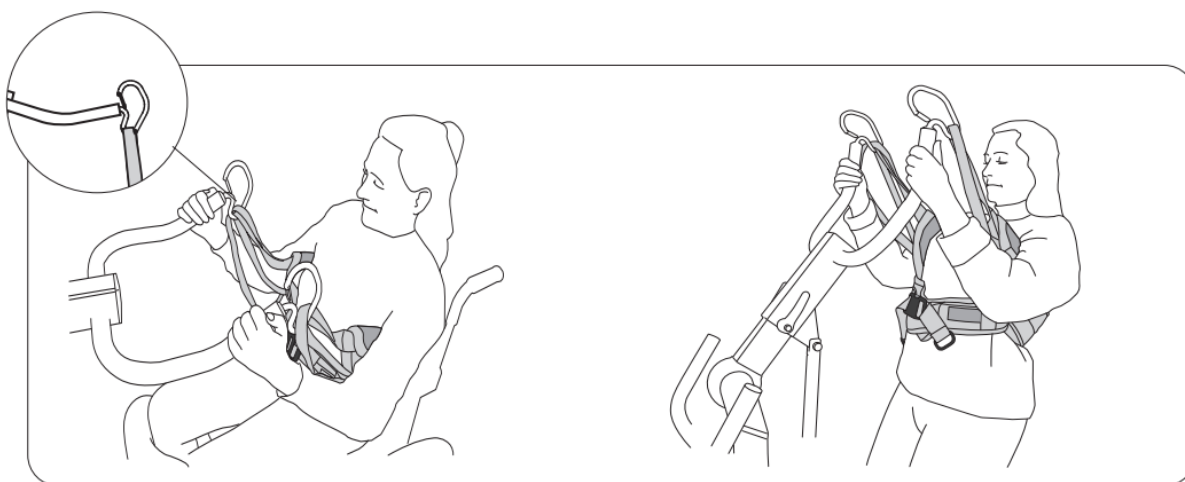

Koppla bandöglorna till lyftbygelns krokar.

⚠ Före uppresning, kontrollera att banden är korrekt kopplade på lyftbygelns krokar.

Uppresning: Manövrera lyftrörelsen med upp- och nedknapparna (två hastigheter finns). Patienten bör om möjligt uppmanas att medverka aktivt genom att fatta tag om lyftbygelns och dra sig upp.

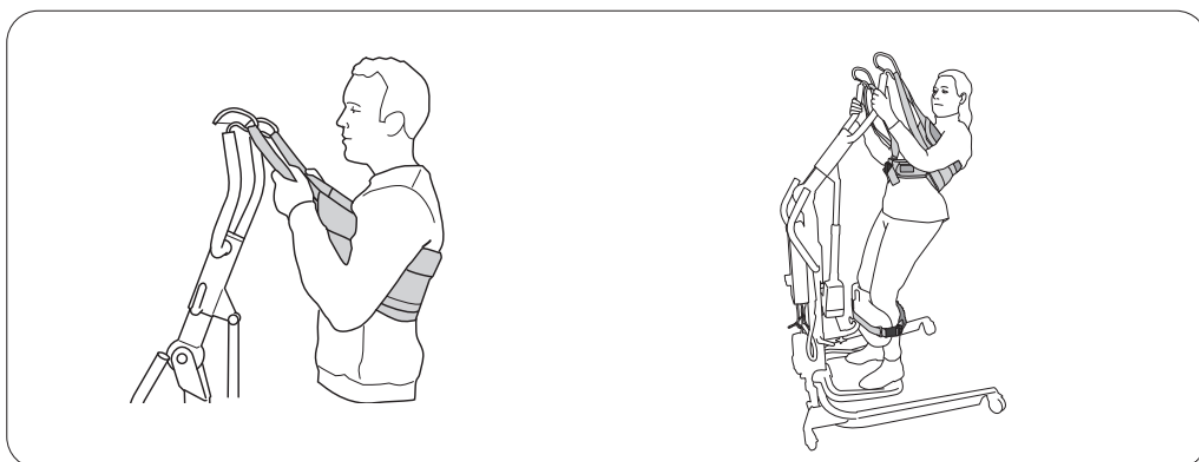

Tips: Om västen glider upp under uppresningen kan patienten ta tag i bandöglorna istället för lyftbygelns. Det bidrar till att hålla västen på plats och ger bra stöd för ryggen vid uppresning.

Vi rekommenderar att patienten under uppresningen lutar överkroppen bakåt för att kompensera för svag sträckmuskulatur i underkroppen. Detta underlättar uppresningen, ökar komforten och motverkar att västen glider uppåt.